特許取得済
特許第 6392138 号

# 軟性内視鏡を クリーンに安全に 乾燥・保管していますか?


消化器内視鏡ガイドラインを参照して
できた新アイテムです!





NEW




## 乾いていると思っていても…


●洗浄ブラシで


●鉗子口に洗浄ブラシを挿入

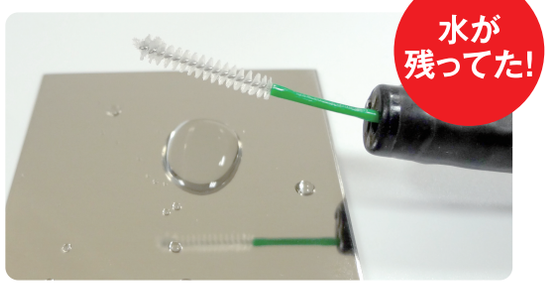



# Compact DEPO

## 軟性内視鏡乾燥保管庫

# 扱いやすさ抜群!!




女性スタッフの方でも
ラクラク手が届きます。

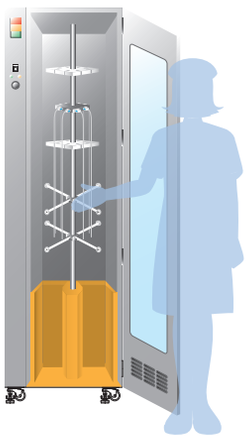


## 設置しやすい装着部



スタッフさんが軟性内視鏡を、ストレスなくセッティングできるよう、装着部を手の届きやすい高さに設計しております。

## アダプター(管路内乾燥用)




吸引ボタン・通気・送水/
挿入口アダプター



吸引ボタン・通気・
送水アダプター装着




鉗子挿入口アダプター装着



器械本体へアダプターを装着し、完了

※チューブには逆止弁がついているので接続しないと、エアーが流れないしくみです。

# 装置へのセットは回転式!!



## コンパクトな回転式

回転させながら軟性内視鏡をセッティングしていきます。ジュラコンの持ち手には、くぼみがついていますので、乾燥させたいものを引っ掛けられます。




## ●デザインは非常にシンプル



### 一目で分かる操作部

電源スイッチ
開始ボタン
停止ボタン
時間タイマーのみで、操作自体非常に簡単です。




### 運転中ランプ

- 庫内が高温になった時(65度以上)
- 運転が停止状態の時、点灯
- 運転中に点灯

# 本当に乾くの?




**[社内乾燥データ] 30分間乾燥すると、内視鏡チャンネル内に残水は確認できません。**




鉗子挿入口から水10cc注入



アダプター接続後、30分運転




水分が付着すると変色する乾燥
インジケーターのサンプルを使用した



インジケーターで洗浄ブラシの
先端・シャフトを拭き取る



変色は見られず、
乾燥が完了している事を確認



## 挿入部・接続部保持パット

垂れ下がった挿入部・接続部を安全に保持します。通気性も良く、高温洗濯が可能です。

■仕様/寸法

| | | | |
|---|---|---|---|
| 製 品 名 | 軟性内視鏡乾燥保管庫 | 運転制御 | 自動専用型マイクロコンピュータ |
| 型 式 | Compact DEPO | 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
| 本体外寸法 | W550×D680×H1,850 (mm)(最大寸法) | 電源容量/消費電力 | 10.5A/1.05kw |
| 開 口 部 | W430×H1,710 (mm) | 発熱量/放熱量 | 450(kcal)/582(kcal) |
| 本体質量 | 120kg | 使用環境 | 周囲温度10~40℃ 相対湿度30~85% |
| 材 質 | ステンレスSUS304 ヘアーライン仕上げ | | |


# 将来のセントラル化に備えて、内視鏡室に置いてみませんか?

製造元 株式会社 アスカメディカル
医療機器製造業許可証 27BZ200023 第2種医療機器製造販売業許可証 27B2X00210

■本社・工場 〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
E-mail : askhm@asukamedical.co.jp

■東京支店 〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663

■福岡営業所 〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号
TEL (092)292-7971 FAX (092)292-7972



マスコットキャラクター
「アスカメちゃん」

直接質問したい方はこちらからどうぞ。

アスカメディカル 問い合わせ 検 索

お問い合わせ先

2020.07.H.1000