［庫内行程ランプ］ 遠くから色を識別する事ができます。

■ 仕様／寸法

製品名	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫	軟性内視鏡除湿乾燥保管庫
型式	DEPO-04	DEPO-08
本体外寸法	1200W×700D×1950H（mm）（最大寸法）	2000W×700D×1950H（mm）（最大寸法）
開口部	870W×1765H（mm）	左扉 820W×1765H（mm）　右扉 820W×1765H（mm）
本体質量	210kg	330kg
材質	ステンレス SUS304　ヘアーライン仕上げ	ステンレス SUS304　ヘアーライン仕上げ
運転制御	自動専用型マイクロコンピュータ	自動専用型マイクロコンピュータ
定格電源	単相 100V　50/60Hz	単相 100V　50/60Hz
電源容量/消費電力	20A/1kw	20A / 1.5kw
発熱量/放熱量	877(kcal)/939(kcal)	1290(kcal)/1693(kcal)
使用環境	周囲温度 10～40℃　相対湿度 30～85%	周囲温度 10℃～40℃　相対湿度 30～85%

※カタログ仕様は予告なく変更することがあります。

■ 関連商品

軟性内視鏡洗浄用 SYSTEM SINK

お客様のご要望に応じて
オーダーメイドの
内視鏡システムシンク
を製作しております。



内視鏡保持ホルダー

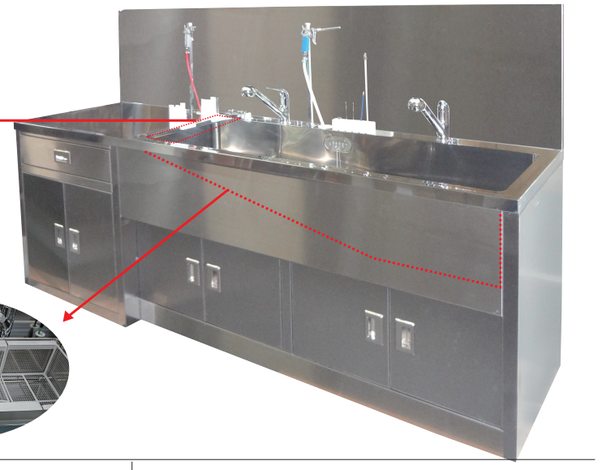

バスケットを重ねれば
場所もとらず
ラクラク収納。
WD洗浄可能!

製造元
株式会社 アスカメディカル
医療機器製造業許可証　27BZ200023　第2種医療機器製造販売業許可証　27B2X00210
■本社・工場　〒536-0008 大阪市城東区関目2丁目12番10号
TEL(06)6939-3011(代) FAX(06)6939-3225
E-mail：askhm@asukamedical.co.jp
■東京支店　〒111-0055 東京都台東区三筋1-12-2 金子ビル1階
TEL(03)5820-5662(代) FAX(03)5820-5663
■福岡営業所　〒812-0004 福岡市博多区榎田1丁目8-28 ツインスクエア3号
TEL (092)292-7971　FAX (092)292-7972

マスコットキャラクター
「アスカメちゃん」

直接質問したい方はこちらからどうぞ。
アスカメディカル　問い合わせ　検　索

お問い合わせ先

2020.07.H,1000

軟性内視鏡をクリーンに安全に乾燥・保管していますか?

**消化器内視鏡ガイドラインを参照して
できた新アイテムです!
洗浄終了時のレベルを維持します。
これが開発コンセプトです。**

ハンガーにかけていると中から水が出るんだ…。
本当に乾いているか不安…

DEPO-04

DEPO-08

低温除湿乾燥で安全に安心乾燥!

軟性内視鏡除湿乾燥保管庫

ASUKAMEDICAL CO.,LTD.

水分残り…ハイリスク汚染は大丈夫?

除湿と風量で 中 も 外 も 「乾燥」→「保管」

乾いていると思っていても…

●洗浄ブラシで



●鉗子口に洗浄ブラシを挿入



内視鏡チャンネル内に、水分が残っていると保管中に細菌が増殖する可能性がある為、内腔もきちんと乾燥します。

DEPO-04

個別の小物ケース



送気・送水ボタン、吸引ボタン、鉗子栓などを個別にケースに入れて頂けます。小物ケースは取り外し可能です。

挿入部・接続部保持パッド

垂れ下がった挿入部・接続部を安全に保持します。通気性も良く、高温洗濯が可能です。

設置しやすい装着部

スタッフさんが軟性内視鏡をストレスなく、装着できるよう、装着部を斜め45度に設定しております。

アダプター



吸引ボタン・通気・送水/挿入口アダプター

吸引ボタン・通気・送水アダプター装着

鉗子挿入口アダプター装着

器械本体へアダプターを装着し、完了

タッチパネル

■ 操作部
各行程を表示します。
タッチパネル式ですので、簡単に行程内容と操作が可能です。



■ 管理記録
No.管理が可能。出し入れ時に番号を押すと、管理記録がモニターで確認できます。※出力データはオプションになります。

HEPAフィルター

DEPO-08

[社内乾燥データ] 30分間乾燥すると、内視鏡チャンネル内に残水は確認できません。

鉗子挿入口から水10cc注入

アダプター接続後、30分運転

水分が付着すると変色する乾燥インジケーターのサンプルを使用した



インジケーターで洗浄ブラシの先端・シャフトを拭き取る

変色は見られず、乾燥が完了している事を確認